

电子床头卡 产品手册_V1.0

M-BS03



● 产品概述

产品 M 电子床头卡 输协议 用
用 嘱等入 。 产品 及排
版。

● 功能特点


- 高档铝合金机身搭配超薄外观设计
- 无需布线，即挂即用
- 基于 LoRa 无线通讯，信号安全稳定
- 超长待机，长达 3 年或以上
- 显示内容即时更新，无需人为干预
- 后台电量集中管理

● 规格参数

电 C 3.3V
电 电 3 00
电 0
电 1 0 00μA
· ·
0 3
1 1
-10


● 产品尺寸图

(L×W×D): 184×125×9 mm

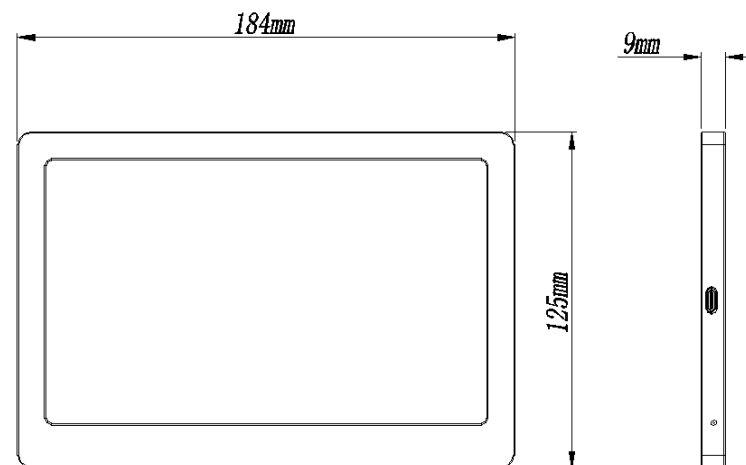

● □ □ □ □

外观接口说

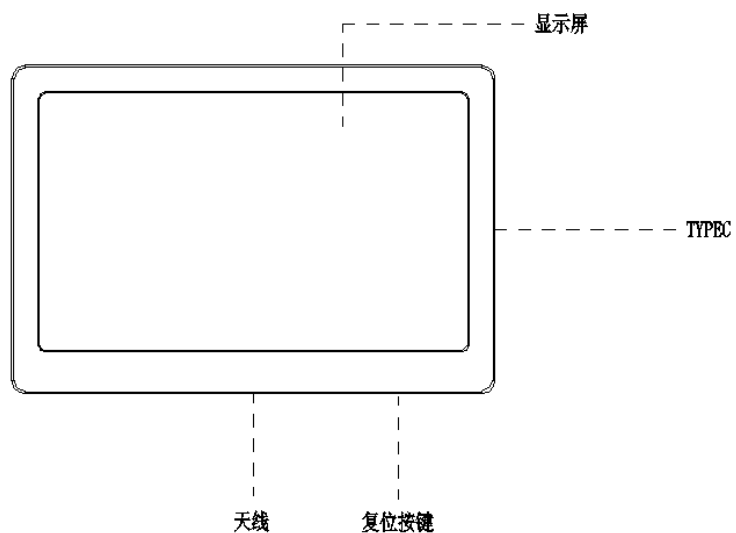

接口说

Type-c: 充电接口;

天线: 用于增强 LoRa 信号;

复位按键: 用于复位。

操 使用提示

本产品需工作人员配置好电子床头卡系统。

患者信息

1、医护人员在医院系统上录入、修改完患者信息;

2、电子床头卡将自动更新录入、修改的患者信息。

电池电量查看

后台服务器可查看电子床头卡电池的使用情况。

● □ □ □ □

① 55mm 55mm 开孔大小3.0mm	第一步: 在设备带上按图 1 挂墙架的开孔大小和开孔距离开孔。
②	第二步: 用螺丝将挂墙架固定在设备带上,然后将设备固定在挂墙架上即可完成安装。
③	第三步: 安装完成后的状态。